



エアロスフィア® 56吸入・120吸入

ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物製剤

56吸入製剤/120吸入製剤 新吸入デバイス発売のご案内

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、3成分配合COPD治療剤「ビレーズトリ®エアロスフィア®120吸入」(一般名: ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物製剤)を発売させていただくこととなりました。また、「ビレーズトリ®エアロスフィア®56吸入」も吸入デバイスを新しく変更し発売させていただくこととなりましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。

今後、「ビレーズトリ®エアロスフィア®56吸入」に加え、120吸入製剤の発売を通じて、慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)治療に貢献してまいります。

今後ともなお一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白
アストラゼネカ株式会社

発売日

2022年6月6日

販売名

ビレーズトリエアロスフィア 56吸入/120吸入

個装ケース外観



吸入器外観



包装・価格

販売名	ビレーズトリエアロスフィア 56吸入	ビレーズトリエアロスフィア 120吸入
包装単位	1本[1本(アルミ袋、乾燥剤入り)×1]	
薬価	4127.60円/1本	8771.90円/1本
個装ケースサイズ	45mm(L)×82mm(W)×141mm(H)	

各種コード

統一商品コード	650703108	650704105
調剤包装単位	 (01)04987650703016	 (01)04987650704013
販売包装単位	(17)000000(10)0000000000  (01)14987650703105	(17)000000(10)0000000000  (01)14987650704102
薬価基準収載医薬品コード	2290805G1027	2290805G2023
個別医薬品コード(YJコード)	2290805G1027	2290805G2023
HOT番号(HOT13)	1268706010201	1268713010201
レセプト電算処理システムコード	622687001	622687101

※この部分はロットごとに異なるため、データはダミーになります。

製造販売元[文献請求先]
アストラゼネカ株式会社
 大阪市北区大深町3番1号
 TEL 0120-189-115
 (問い合わせ先フリーダイヤル メディカルインフォメーションセンター)


ビレーズトリ®エアロスフィア® 56吸入/120吸入 新吸入デバイスのご案内



このたび、COPD 治療配合剤「ビレーズトリ® エアロスフィア®56 吸入/120 吸入」(一般名:ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物製剤))について、製造販売承認事項一部変更承認を取得し、吸入デバイスを変更の上、120吸入製剤を追加販売いたします。従来の吸入デバイスからの変更点と、吸入補助器具の変更点等について、ご案内申し上げます。

①外観の変更

インジケーターが大きくなり、矢印は1噴霧ごとに進み、残りの噴霧回数がわかりやすくなりました。

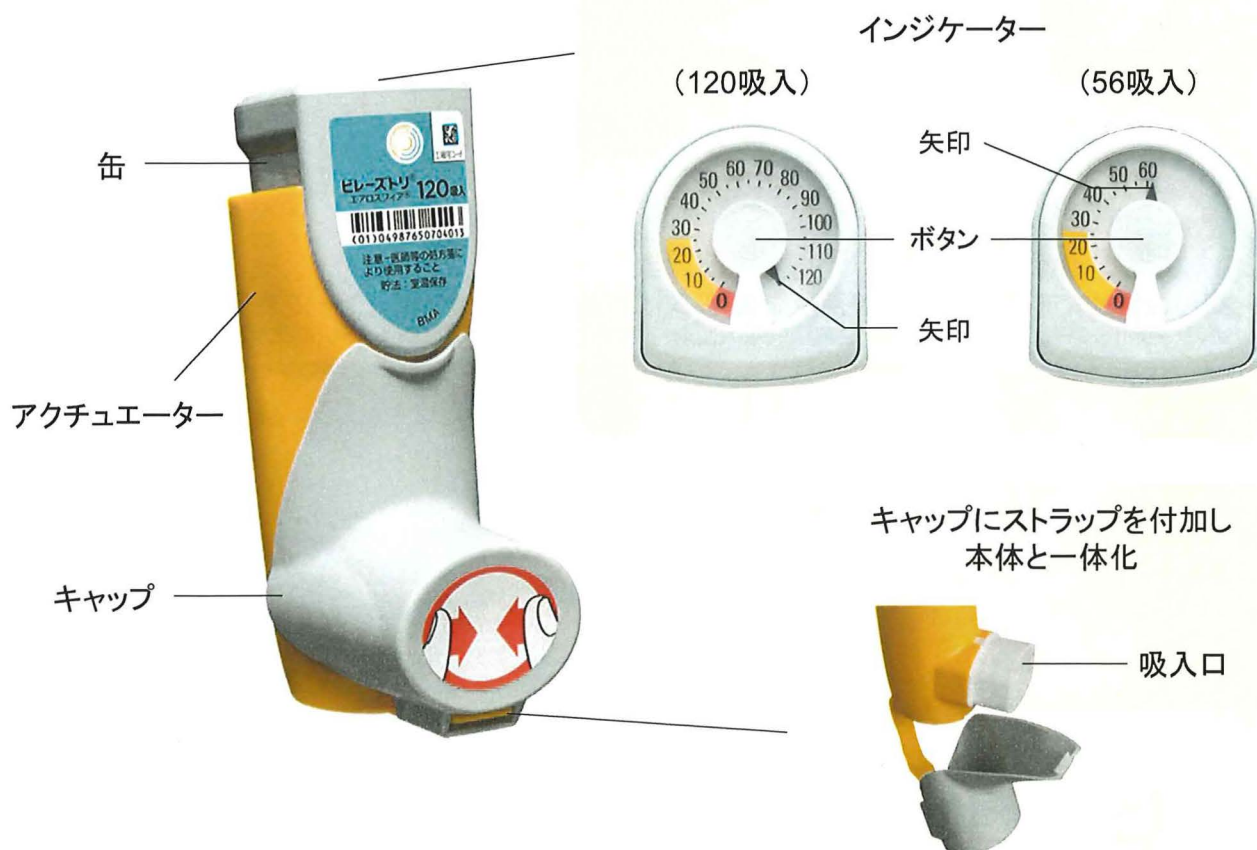

⑤準備操作

未使用の吸入器をはじめて使用するときの準備操作において、
空噴霧の回数は、120吸入製剤は「**2度**」、56吸入製剤は「**4度**」になります。

従来の吸入デバイス



！ 未使用の吸入器を使用するときは、以下の操作が必要です

A キャップを外し、よく振る	B ボタンを押して、1度空噴霧をする
A・B の操作を、合計で 4度 繰り返します。	

新吸入デバイス

ビレーズトリ**120吸入**製剤の
準備操作の空噴霧回数は「**2度**」



！ 未使用の吸入器をはじめて使用するときの準備操作

A キャップを外し、よく振る	B ボタンを押して、1度空噴霧をする
120吸入 A・B の操作を、合計で 2度 繰り返します。	
56吸入 A・B の操作を、合計で 4度 繰り返します。	

●よくあるお問い合わせ

Q1

Q 製造販売承認事項一部変更承認の位置づけは？

A 製造販売承認事項一部変更承認は、既に承認取得している薬剤から承認事項の一部の変更を申請し、一部変更承認を取得する承認申請になります。
新吸入デバイスのビレーズトリ®エアロスフィア® 56吸入製剤・120吸入製剤については、吸入デバイスのみの変更を申請しており、成分や有効性、安全性については、既承認内容から変更はございません。

Q2

Q 新吸入デバイスでは、どのスプレーヤーが使用できますか？

A 特に推奨しているスプレーヤーはございません。スプレーヤーの詳細等については、スプレーヤーの各メーカーにご確認ください。

Q3

Q 新吸入デバイス用のプッシュサポーターはありますか？

A ビレーズトリ®エアロスフィア®の新吸入デバイスにのみ使用できる、新しいプッシュサポーターを用意しております。こちらは、従来の吸入デバイスでは使用できません。