

脳脊髄手術用洗浄・灌流液

アートセレブ® 脳脊髄手術用洗浄灌流液

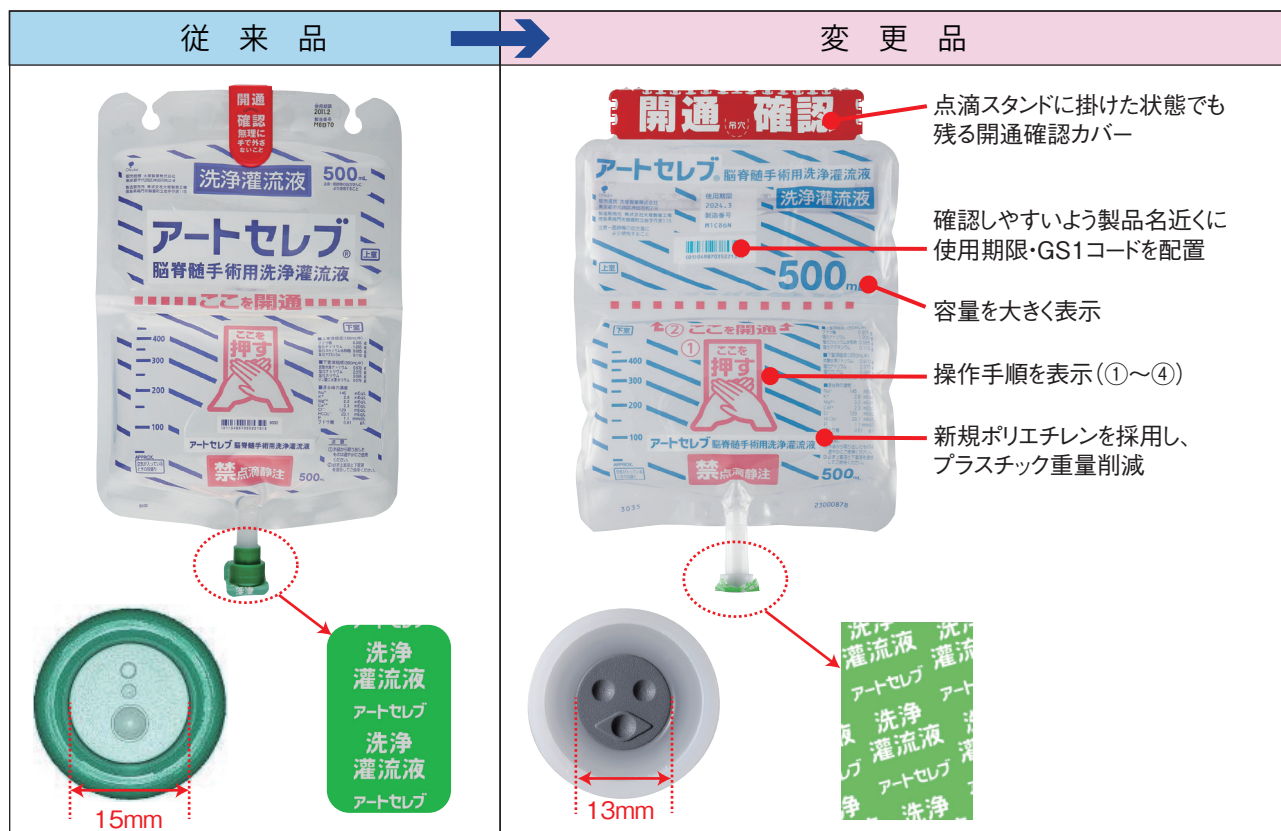
包装表示変更のご案内

このたび、標記製品の容器、外袋及び梱包ケースを変更しましたので、ご案内申し上げます。

変更内容

■ 隔壁未開通投与防止のための開通確認カバーの仕様を変更し、医療廃棄物削減と環境に配慮した容器・包装に変更しました。表示も一新しました。

【容器バッグ等】



① 隔壁未開通投与防止のために

- ・開通確認の文字を大きく表示し、点滴スタンドに掛けた状態でも残る開通確認カバー(吊り部カバー)に変更しました。
- ・隔壁開通操作時に開通手順がわかるよう、操作手順を表示しました。

② 視認性向上のために

- ・容量の表示を大きくしました。
- ・使用期限・製造番号及びGS1コードを上室の製品名の近くに配置しました。



③ 廃棄物削減及び環境への配慮のために(環境配慮型製品への取り組み)

- ・新規ポリエチレンを採用し、開通確認カバーの仕様等を変更しました。

④ その他の変更

- ・ポートの仕様を変更し、色を緑色からナチュラル色(樹脂そのものの色)に変更しました。
- ・ゴム栓の直径を15.0mmから13.0mmに変更しました。

(裏面もご参照ください。)

従 来 品	変 更 品
●容器 (開通前) 開通確認カバー(PP成形品) →開通確認後に取り外す 	●容器 (開通後) 開通確認カバー(PP主原料の合成紙) →開通確認後も残る  表面 裏面 下室を押して開通を確認後、吊穴をあける。
●外袋 	●外袋  記載場所を変更 操作手順を表示   

■ 変更品のLot No.及び出荷予定時期

製 品 名	包 装	統一商品コード	Lot No.	出荷予定時期
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL×20袋	035-22130-2	M1C86N	2022年6月頃

当分の間、変更した梱包ケースのバーコードシールには、**包装表示変更品**を表示いたします。
 製品流通の面から、変更品がお手元に届く時期が出荷予定時期と異なることもございますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



Otsuka

販売提携

大塚製薬株式会社

製造販売元

株式会社大塚製薬工場

お問い合わせ先: 株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター TEL 0120-719-814 受付時間 9:00~17:30(土・日、祝日、弊社休業日を除く)