

表示変更のご案内

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社販売のワクチンシリンジ製剤につきまして、視認性の向上(含む、誤接種防止)を目的として個装箱及びブリストアフィルムの表示を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

なお、組成・性状、効能又は効果、用法及び用量は従来品と変わりありません。

何卒ご了承を賜りますとともに、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

●対象製品

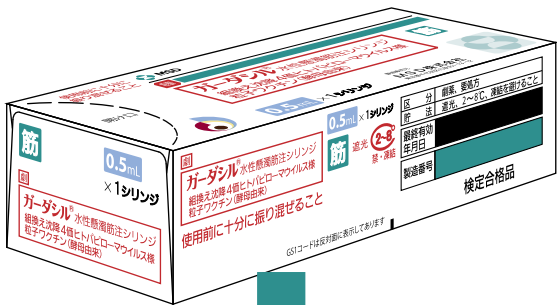
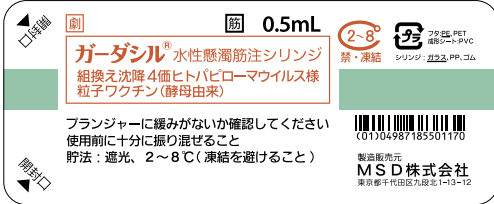
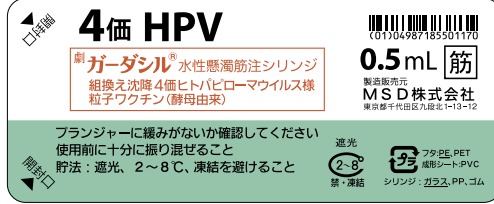
- ・ガーダシル®水性懸濁筋注シリンジ
- ・シルガード®9 水性懸濁筋注シリンジ
- ・ニューモバックス®NPシリンジ
- ・ヘプタバックス®-Ⅱ 水性懸濁注シリンジ 0.25mL/0.5mL

※インフルエンザワクチン(ビケンHA、フルービックHAシリンジ)、ロタテック® 内用液は変更ありません。

●変更内容

- ・個装箱及びブリストアフィルムの表示を変更いたします。
 - ・各ワクチンの種別・記号を表示いたします。
- 各製品の表示は以降をご覧ください。

1. ガーダシル® 水性懸濁筋注シリンジの変更内容

	個装箱	ブリストアフィルム
従来品		
変更品		

表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「4価 HPV」の表示及び緑色帯を表示いたします。

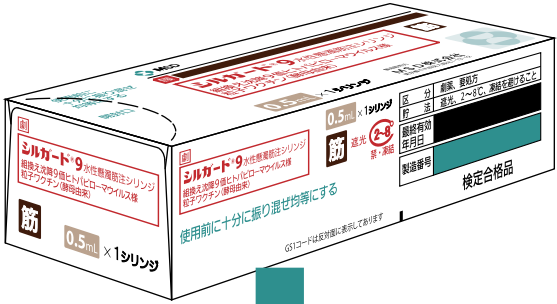
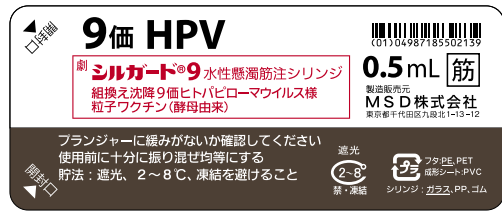
※内面をご覧ください。【👉】

MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

表示変更のご案内

2. シルガード® 9 水性懸濁筋注シリンジの変更内容

	個装箱	ブリスターフィルム
従来品		
変更品		

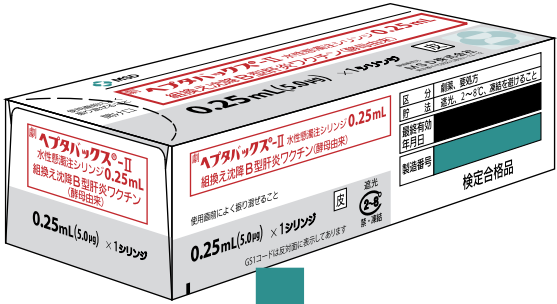
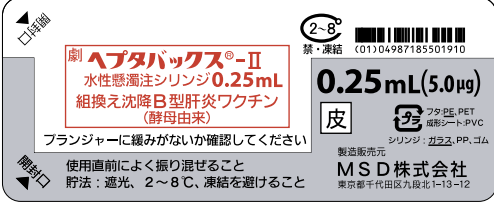
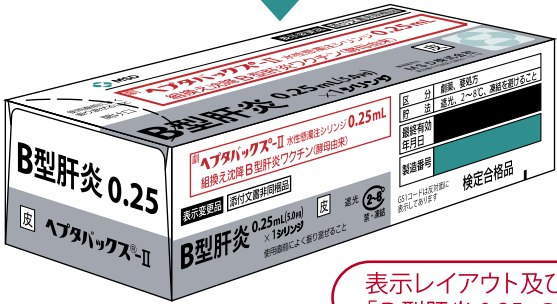
表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「9価 HPV」の表示及び茶色帯を表示いたします。

3. ニューモバックス® NP シリンジの変更内容

	個装箱	ブリスターフィルム
従来品		
変更品		

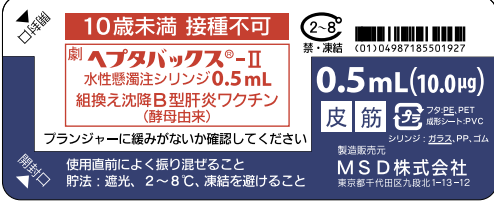
表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「23価 肺炎球菌」の表示及び黄色帯を濃い紫色に変更いたします。

4. ヘプタボックス® - II 水性懸濁注シリンジ0.25mLの変更内容

	個装箱	ブリスターフィルム
従来品		
変更品		

表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「B型肝炎 0.25」の表示及び灰色帯を濃くいたします。

5. ヘプタボックス® - II 水性懸濁注シリンジ0.5mLの変更内容

	個装箱	ブリスターフィルム
従来品		
変更品		

表示レイアウト及びデザインを変更いたします。
「B型肝炎 0.5」の表示をいたします。

表示変更のご案内

●変更品表示

当分の間、個装箱には **表示変更品** と表示いたします。

●変更品の出荷予定時期

品 名	包 装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
ガーダシル® 水性懸濁筋注シリンジ	1シリンジ	185-80840-8	未 定	2022年 7～9月
シルガード® 9 水性懸濁筋注シリンジ	1シリンジ	185-81060-9	未 定	2023年 4～6月
ニューモボックス® NPシリンジ	1シリンジ	185-81061-6	未 定	2022年 10～12月
ヘプタボックス® -Ⅱ 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	1シリンジ	185-81010-4	未 定	2023年 1～3月
ヘプタボックス® -Ⅱ 水性懸濁注シリンジ 0.5mL	1シリンジ	185-81011-1	未 定	2023年 4～6月

※包装変更品の出荷時期は、弊社在庫状況により、出荷予定時期と異なる場合がございます。

※製造番号及び出荷予定時期につきましては、確定いたしましたら改めてお知らせいたします。ご了承ください。

MSD株式会社
東京都千代田区九段北1-13-12

製品のお問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター
医療関係者の方 ☎ 0120-024-961

<受付時間> 9:00 ～ 17:30 (土日祝日・当社休日を除く)

GS/SG/NPS/HTS-01
202203