

トレイ仕様等変更のご案内

ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤

エムガルティ® 皮下注120mg オートインジェクター エムガルティ® 皮下注120mg シリンジ

このたび上記製品につきまして、シリンジ製剤のトレイの仕様等を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

2024年1月

対象製品

エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター 1mL[1オートインジェクター]

エムガルティ皮下注120mgシリンジ 1mL[1シリンジ]

変更内容

	トレイ仕様変更 個装箱・梱包箱サイズ、入数変更	個装箱表示変更
エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター	—	○ 注意文追記のみ
エムガルティ皮下注120mg シリンジ	○	○

【トレイ仕様変更】

- シリンジ製剤は、環境負荷の低減を目的とし、トレイの材質をプラスチックから紙に変更します。
また、トレイを入れているプラスチックの袋を廃止します。これに伴い、個装箱のリサイクルマークから袋、トレイの表示を削除します。

変更前



変更後



- トレイの仕様変更に伴い、シリンジ製剤は、個装箱・梱包箱のサイズおよび入数を変更します。

	変更前	変更後
個装箱	70x40x180(mm)	55x35x152(mm)
梱包箱	370x295x178(mm)	352x323x192(mm)
入数	32	60

製造販売元

 日本イーライリリー株式会社


販売元

 第一三共株式会社

【個装箱表示変更】

- 「本剤はこの箱に入れたまま冷蔵庫(2～8℃)に遮光保存してください。」の注意文を追記します。
- シリンジ製剤は、個装箱のサイズ変更に伴い、一部販売名の表示レイアウトを変更します。また、「製造番号LOT」「使用期限EXP」の表示から「LOT」「EXP」を削除します。

<表示例:エムガルティ皮下注120mgシリンジ>

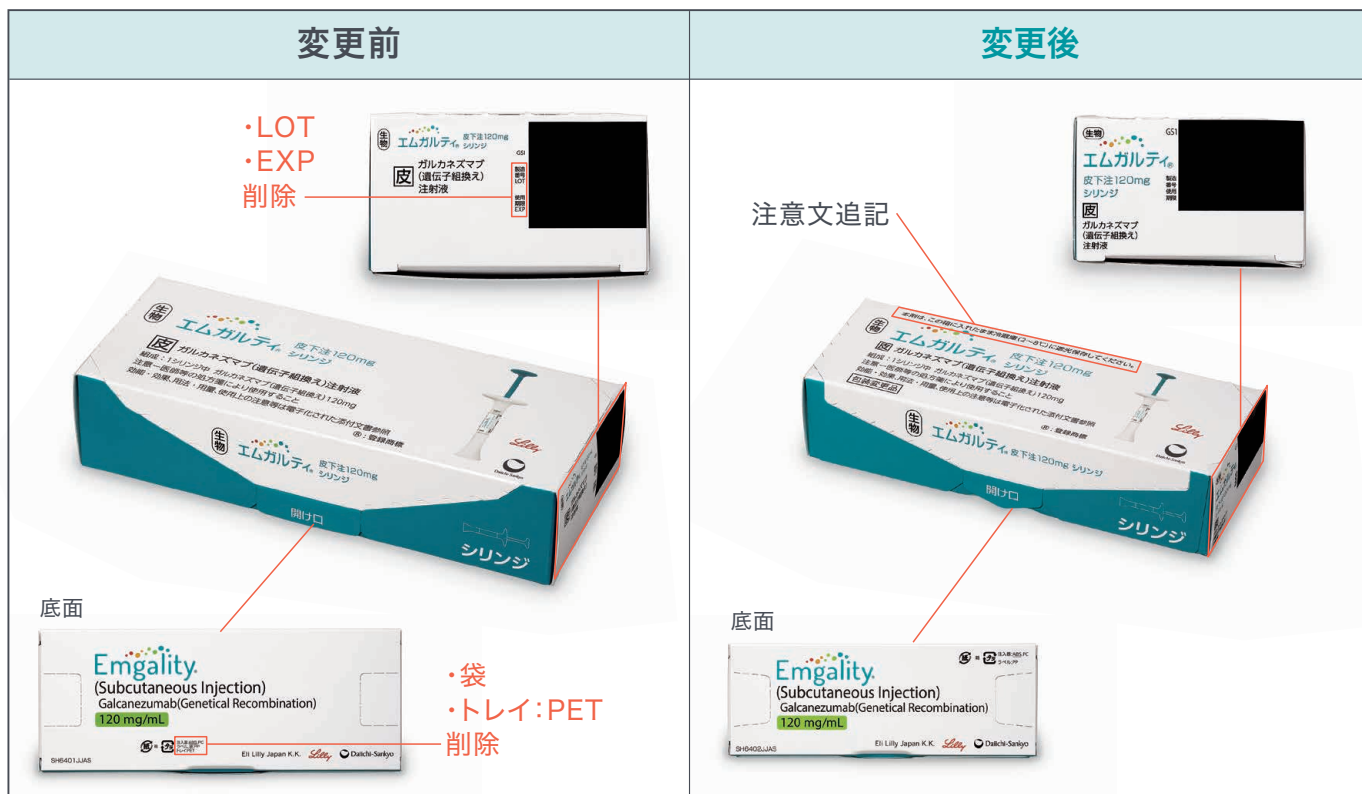

患者さん用説明カード

シリンジ製剤のトレイの仕様変更に伴い、患者さん用に説明カードを用意しております。
製品には封入しておりませんので、ご利用の際は弊社MRにお申し付けください。

患者さんへ

- トレイの材質をプラスチックから紙に変更し、トレイが入っている袋を廃止しました。
- お薬は従来と変わりませんので、安心してお使いください。

エムガルティ皮下注120mgシリンジ

PP-GZ-JP-2046 ALL1X147-OSW 2024年1月作成

※1冊:10枚綴り

変更品の識別方法

シリンジ製剤の個装箱、梱包箱に **包装変更品** と表示いたします。

変更品の出荷予定時期、製造番号

品名	包装	統一商品コード	出荷予定時期	製造番号
エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター	1mL [1オートインジェクター]	081-109807	2月中旬	D641271AG
エムガルティ皮下注120mg シリンジ	1mL [1シリンジ]	081-109814	3月中旬	D641270DC

※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

以上