

アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB₁液

ビーフリード® 輸液

表示変更のご案内

このたび、標記製品の容器及び外袋の表示等を変更いたしましたので、ご案内申し上げます。

変更内容

■ 隔壁未開通投与防止のため、容器及び外袋の表示内容を変更しました。

- 容器の表示等変更
 - ・調製手順の流れが確認できるよう上室に『調製手順①②③』を追加し、調製手順のアイコンが目立つよう矢印を太くするなどデザインを変更しました。
 - ・印刷方法を変更し、隔壁部分へ『ここを開通』の文字を移動しました。
 - ・使用期限・製造番号(ロット)の印字方法を変更しました。
 - ・開通操作前の液面位置を確認しやすくするため、上室の枠の一部を削除しました。
 - ・開通確認カバーに「操作手順①→②→③」とイラストを追加しました。
 - ・開通確認カバーの裏面に「開通」「確認」を追記し、開通確認カバーを起す際に、開通確認できるようにしました。

例)ビーフリード輸液 (500mL)


従来品	変更品
<p><開通後></p> 	<p><開通後> 操作手順とイラストの追記</p>  <div data-bbox="1101 1198 1444 1422" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p><隔壁開通カバー裏面> 「開通」「確認」を追記</p>  </div> <ul style="list-style-type: none"> 使用期限・製造番号の印字方法を変更 調製手順が分かるように①②③を追加 中央隔壁部分に「ここを開通」を移動 開通確認の矢印の形状を変更 <p style="text-align: right;">容器の印刷方法を変更</p>

(裏面もご参照ください。)

●外袋の表示変更

- ・操作方法の①開通にイラストを追加しました。
- ・イラストと注意書きの表示位置を変更しました。
- ・注意書きの記載内容を電子化された添付文書に揃えました。

例)ビーフリード輸液 (500mL)

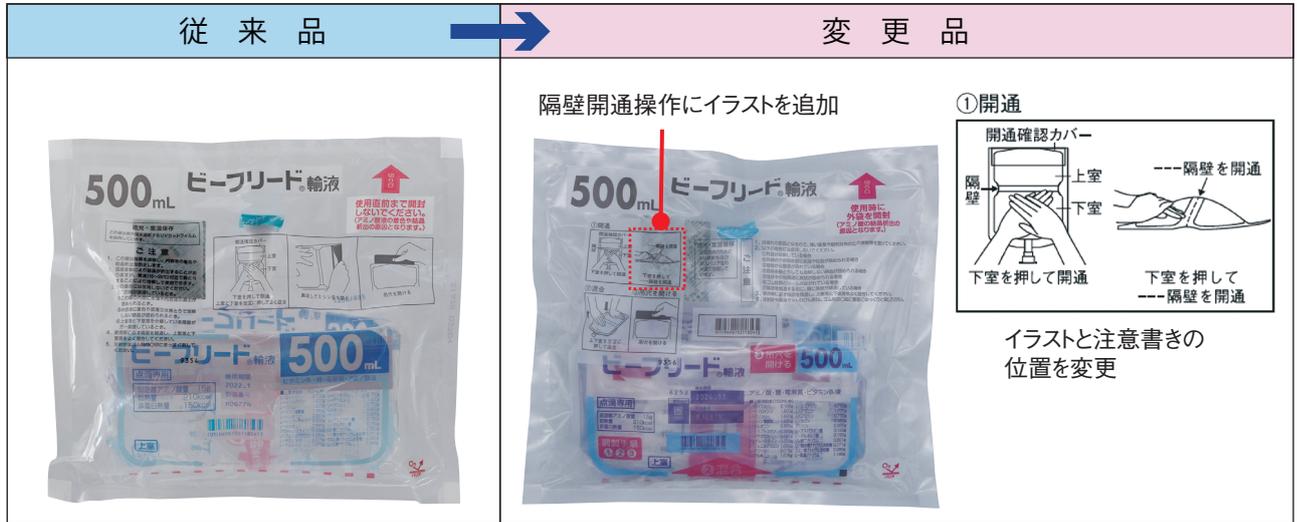

●梱包ケースの表示変更

- ・容器の表示内容に合わせ、製品タイトルの記載順を変更しました。

例)ビーフリード輸液 (1000mL)



■ 変更品の出荷予定時期

製品名	包装	統一商品コード	出荷予定時期
ビーフリード輸液	500mL×20袋	035-18540-6	2023年12月頃
	1000mL×10袋	035-18550-5	2023年12月頃

当分の間、変更した梱包ケースのバーコードシールには、**表示変更品** を表示いたします。

製品流通の面から、変更品がお手元に届く時期が出荷予定時期と異なることもございますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



Otsuka

販売提携

大塚製薬株式会社

製造販売元

株式会社大塚製薬工場

お問い合わせ先: 株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター TEL 0120-719-814 受付時間 9:00~17:30(土・日、祝日、弊社休業日を除く)